

兰州大学草地农业科技学院实验室安全

工作简报

2022 年第 1 期（总第 7 期）

草地农业科技学院实验室安全工作小组 2022 年 1 月 12 日


2022 年 1 月 12 日，为切实做好实验室安全工作，学院副院长范成勇，实验室安全工作小组成员古丽君、黄文丽、张祖欣、马宝宏对碧野楼、逸夫生物楼四楼、岫云楼、校医院四楼的各实验室安全进行了检查，大部分实验室的安全管理及环境卫生状况较之前有了很大改善，但个别实验室仍存在安全隐患，要求限期整改。

一、表现较好实验室

以下实验室的管理方法科学，管理措施规范，值得借鉴和学习：

- (1) 碧野楼 804 冰箱内物品摆放整齐；
- (2) 碧野楼 800 危化品试剂柜使用规范；
- (3) 碧野楼 7 楼化学品目录方便学生查询；
- (4) 碧野楼 607 废液处理记录及仪器使用记录详细清楚，记录规范；
- (5) 碧野楼 509 冰箱使用规范：提示不能存放有机试剂；
- (6) 碧野楼 502 通风橱旁放置的防护用品方便取用；
- (7) 碧野楼 401 学生做试验时实验室环境整洁，学生防护措施得当；
- (8) 碧野楼 315 实验室废液桶标识清晰，废液收集方式安全合理；


- (9) 碧野楼 302 学生做试验时实验室环境整洁，学生防护措施得当；
- (10) 碧野楼 202 样品存放整齐美观；
- (11) 碧野楼 101 实验室环境整洁；
- (12) 生物二号楼 403 高压灭菌器登记规范；
- (13) 岫云楼 311 培养箱使用记录详尽全面；
- (14) 岫云楼 404 药品柜危险化学品安全周知卡方便查阅；

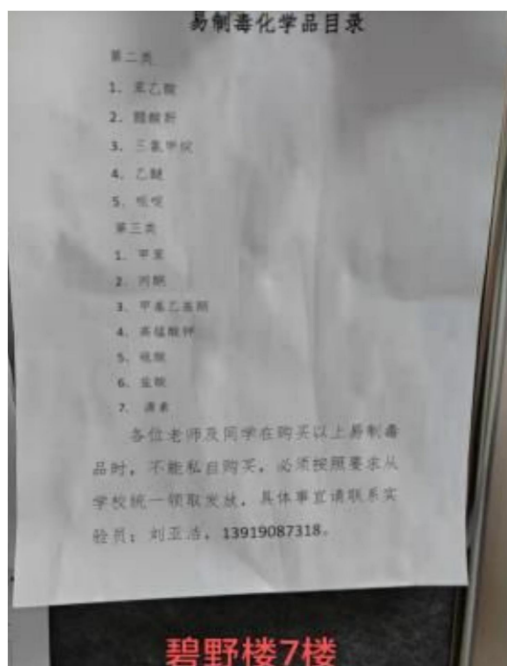







碧野楼101



碧野楼302

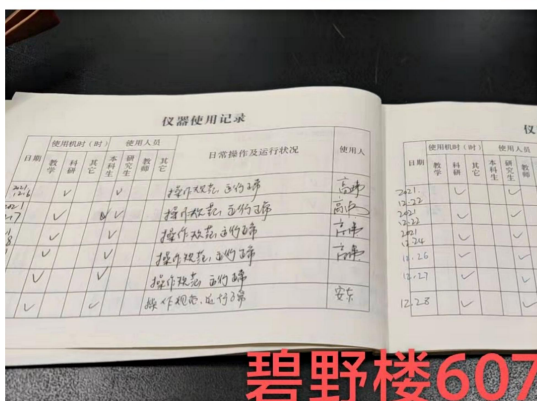

碧野楼607



岫云楼311

二、 主要存在隐患和问题

插线板未固定且在地面放置；废液桶未贴标签；配置溶液标识不清；实验室垃圾桶有食物垃圾且不及时清理；用完的危化品不及时收纳；危险化学试剂柜不上锁；高压灭菌锅无操作规程且无上岗证。

三、 现场照片



碧野楼 502



碧野楼 801



校医院



校医院



1楼大型仪器平台




碧野楼 301



碧野楼 601



生物楼 401 A



碧野楼 807



碧野楼 801



生物楼 401 A

四、实验室问题清单

实验室房号	责任人	问题	建议整改措施	限期整改完成时间	复查结果
碧野楼 F102	吴彩霞 高红娟	废液桶未标识	建议规范废液桶标识	立即	已整改
碧野楼 301	方龙发 刘文献	插线板未固定	建议固定插线板	1月14日	已整改
碧野楼 301	方龙发 刘文献	试剂标识不清	建议规范配置溶液标签	1月14日	已整改
碧野楼 301	方龙发 刘文献	高压灭菌锅无操作规程且无上岗证	建议补充操作规程并持有上岗证	4月12日	部分已整改,目前正在准备参加上岗证考试

实验室房号	责任人	问题	建议整改措施	限期整改完成时间	复查结果
碧野楼4楼	侯扶江 常生华	消防通道堆放杂物	建议清理干净，保障消防通道畅通	1月14日	已整改
碧野楼415	侯扶江 常生华	试剂标识不清	建议规范配置溶液标签	立即	已整改
碧野楼406	侯扶江 常生华	废液桶未标识	建议规范废液桶标识	立即	已整改
碧野楼502	王静 吴淑娟	通风橱摆放硫酸	建议规范试剂管理	立即	已整改
碧野楼507	王静 吴淑娟	消防通道堆放杂物	建议清理，保障消防通道畅通	1月14日	已整改
碧野楼601	沈禹颖 杨倩	废液桶未标识	建议规范废液桶标识	1月14日	已整改
碧野楼710	刘亚洁 胡小文	试剂标识不清	建议规范配置试剂标签	1月14日	已整改
碧野楼801	张吉宇 谢文刚	试剂标识不清	建议规范配置试剂标签	1月14日	已整改
碧野楼801	张吉宇 谢文刚	未及时打扫卫生	建议安排好值日生，确保室内卫生状况良好	1月14日	已整改
碧野楼807	韩云华	仪器使用记录本未登记	建议做好使用记录	1月14日	已整改
碧野楼807	韩云华	实验台卫生未及时打扫	建议安排好值日生，确保室内卫生状况良好	1月14日	已整改
生物楼403a	未丽	插线板未固定	建议固定插线板	1月14日	已整改
生物楼401a	未丽	废液桶未标识	建议规范废液桶标识	1月14日	已整改
岫云楼308	李春杰 古丽君	插线板未固定	建议固定插线板	1月14日	已整改